

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต (สายสีส้ม)

คุณลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์

- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล สามารถแสดงค่า Systolic Diastolic และ Pulse ในเวลาเดียวกัน
- พกพาสะดวก

คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์

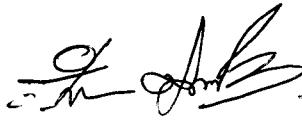
- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล สามารถแสดงค่า Systolic Diastolic และ Pulse ในเวลาเดียวกัน
- ระบบการวัด Oscillometric Method (Double Cuff Method)
- พิสัยการวัด ความดันโลหิต 20– 280 มม.ปดาท และ อัตราชีพจร 30 – 199 ครั้ง/นาที
- ความเที่ยงตรง ตามค่าแนะนำของ AAMI guidelines
- การสูบลมโดยปั๊มลมเข้าปลอกแขนด้วยการบีบลูกสูบ และผ่อนลมโดยอัตโนมัติ(Inflation method) พร้อมทั้งตรวจวัดค่า Systolic Diastolic และ Pulse อัตโนมัติ
- โหมดการวัดมี 3 โหมด Normal mode, Slow mode, Auscultation mode เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพของผู้ป่วย
- เครื่องสามารถทำ Tourniquet Test ได้
- แหล่งพลังงานใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ “AA” 1 ก้อน
- จำนวนครั้งที่วัดได้ประมาณ 1,000 ครั้ง เมื่อแบตเตอรี่เต็ม
- ต้องมีระบบตรวจค่าความเที่ยงตรง เพื่อรับระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
- รับประกันคุณภาพสินค้า 12 เดือน นับแต่วันส่งมอบสินค้า
- สายของเครื่องวัดความดันโลหิตต้องเป็นสีส้มเท่านั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งแยกเครื่องวัด ความดันโลหิต ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อดือยาให้แตกต่างจากเครื่องวัดความดันโลหิตทั่วไป

 นันต์ โลหิต
(นางสมบูรณ์ นันต์โลหิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นิยม วงศ์
(นางสมสมัย บุญส่อง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 รำไพพรรณี ศุขเกษม
(นางรำไพ ศุขเกษม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ